

NLS INSTALLATION MANUAL

NLS telepítési kézikönyv



NLS Device



Bio-inductor



Resonant chamber



Extension cord of inductor



USB cable



Dongle




Flash disk

1. A szoftver telepítésekor vagy használatakor először be kell zárnia az összes vírusirtó programot.
2. A telepítés után menjen a vírusirtó szoftver beállításaihoz, és keresse meg a Kizárások részt, adja hozzá az NLS szoftvert a kizárások listájához. Ezután a vírusirtó szoftver többé nem fogja zavarni Önt. (Valójában a szoftverben nincs vírus, mert a szoftverünk titkosított, és a vírusirtó vírusnak tekinti).
3. Az USB-kábelrel csatlakoztassa az NLS eszközt a számítógépéhez.





4. **Introduceți** Helyezze be a hordozható memóriát (flashlemez) a számítógépbe.

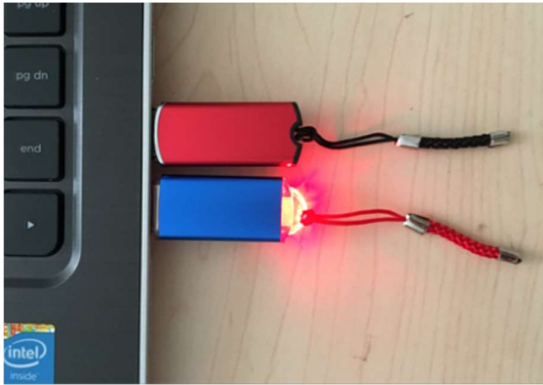

Nincs fény egy dongle.
A szoftver telepítésekor és a szoftver használatakor ezt a Dongle-t mindig be kell dugni a számítógépbe. Ez egy kulcs az eszköz használatához.


Piros fénnel a telepítéshez szükséges dongle.

5. Kattintson duplán a Setup fájlra.



6. Kattintson a Tovább > (Next)



7. Ne változtassa meg a telepítési könyvtárat, kattintson a Tovább > gombra.

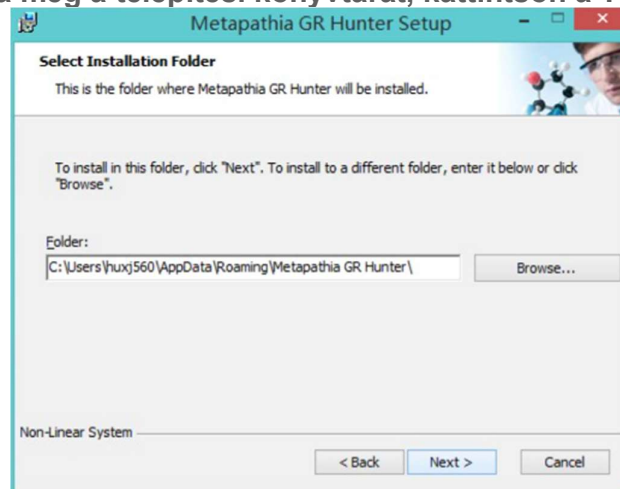

8. Kattintson a Telepítés, majd a Befejezés gombra.

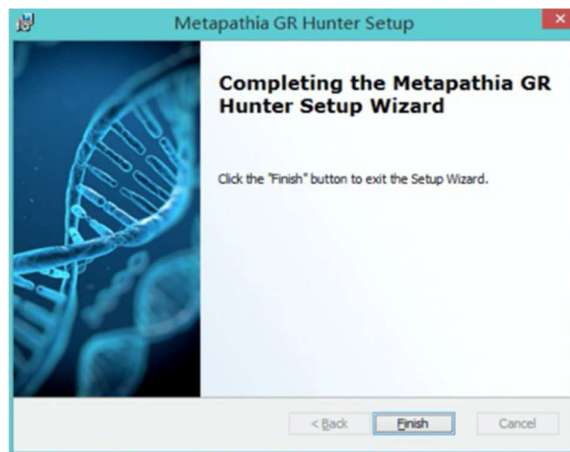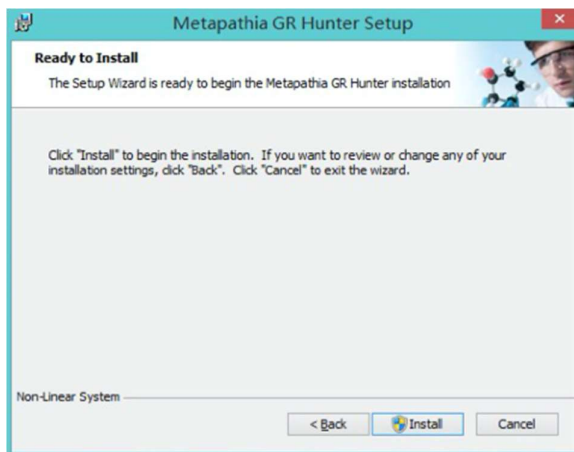

9. A bioinduktort (fejhallgatót) a fülön kell viselni és szorosan le kell fedni, nem lehet nyilvánvaló szivárgás, mivel az erős fény befolyásolja az eredményt vagy hirtelen leállítja a vizsgálatot..



FIGYELEM!

Ha a számítógépen egy másik biorezonancia diagnosztikai szoftver (illesztőprogram) van telepítve, a program nem fog helyesen települni, ebben az esetben először a régi szoftvert és illesztőprogramokat kell eltávolítani, majd alkalmazni a telepítést (1-9. lépés).