Flaem Puppy aeroszolos gép

Használati utasítás

A Flaem Puppy aeroszolos készülék egy kompresszor egységből, egy porlasztóból és néhány kiegészítőből áll.

Rendeltetésszerű használat

Gyógyászati eszköz gyógyszerek inhalációval történő beadására, inhalációs terápiával és orvos által felírt gyógyszeres kezeléssel.

Használati javallatok

Légúti betegségek kezelése. A gyógyszereket olyan orvosnak kell felírnia, aki értékelte a beteg általános állapotát.

Ellenjavallatok

Az orvostechnikai eszköz NEM használható olyan betegeknél, akik nem tudnak önállóan lélegezni vagy eszméletlenek.

Ne használja a készüléket érzéstelenítésben vagy lélegeztetőrendszerben.

Szándékos felhasználók

Az eszközöket törvényileg felhatalmazott egészségügyi személyzet/egészségügyi dolgozók (orvosok, nővérek, terapeuták stb.) általi használatra szánják. A készüléket közvetlenül a páciens használhatja.

Betegek célcsoportja

Felnőttek, minden korú gyermek, csecsemők.

A készülék használata előtt figyelmesen el kell olvasni a használati útmutatót, és a biztonságért felelős felnőttnek jelen kell lennie, ha a készüléket csecsemők, bármilyen korú gyermek vagy korlátozott képességű (például: testi, szellemi vagy érzékszervi) személyek használják. Az egészségügyi személyzet feladata, hogy felmérje a beteg állapotát és képességeit, hogy a terápia felírásakor megállapítsa, képes-e a beteg önállóan biztonságosan működtetni az aeroszolt, vagy a terápiát felelős személynek kell-e alkalmaznia.

Kérjük, konzultáljon az egészségügyi személyzettel, hogy értékelje a készülék használatát bizonyos típusú betegeknél, például terhes nőknél, szoptató nőknél, csecsemőknél, fogyatékkal élőknél vagy korlátozott fizikai képességű személyeknél.

Működési környezet

Ez az eszköz használható egészségügyi intézményekben, például kórházakban, járóbeteg-szakrendeléseken stb., de akár otthon is.

Figyelmeztetések az esetleges meghibásodásokra vonatkozóan

Ha a készülék nem működik, forduljon a hivatalos szervizközponthoz a pontosításért.

Az üzemeltetéssel kapcsolatos problémák és/vagy váratlan események bejelentése és szükség esetén a használat és/vagy karbantartás/higiénés előkészítés tisztázása érdekében a gyártóhoz kell fordulni.

Kérjük, tekintse meg a meghibásodási előzményeket és annak megoldását is.

Figyelmeztetések

- A készüléket csak terápiás inhalátorként használja. Ez az orvosi eszköz nem életmentő eszköz. Minden más használat helytelennek minősül, és veszélyes lehet. A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatért;

- Mindig konzultáljon háziorvosával a kezelés meghatározása érdekében;

- Kövesse kezelőorvosa vagy a légúti rehabilitációs terapeuta utasításait a gyógyszer típusával, adagolásával és kezelési javallatával kapcsolatban;

- Ha a készülék használata közben allergiás reakciókat vagy egyéb problémákat észlel, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon orvosához;

- Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra;

- Ha a csomagolás sérült vagy felnyílt, forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizközponthoz;

- Ne tegye ki a készüléket különösen szélsőséges hőmérsékletnek;

- Ne helyezze a készüléket hőforrások közelébe, napfényre vagy túl meleg környezetbe;

- A tárolásból az üzemi körülmények közé való átálláshoz szükséges idő körülbelül 2 óra;

- A kompresszorcsoport nyílásaihoz bármilyen módon hozzáférni tilos. Javítást csak a gyártó által felhatalmazott személyzet végezhet. A jogosulatlan javítás érvényteleníti a garanciát, és veszélyt jelenthet a felhasználóra nézve;

Fulladásveszély:

- A készülék egyes alkatrészei elég kicsik ahhoz, hogy gyermekek lenyeljék őket, ezért ne hagyja a készüléket gyermekek kezébe;

A fulladás veszélye:

- A mellékelt összekötő tömlőt, kábeleket rendeltetésszerűen ne használja, fulladásveszélyt okozhat, fokozottan ügyeljen a gyermekekre és a speciális nehézségekkel küzdő személyekre, gyakran ezek az emberek nem tudják helyesen felmérni a veszélyeket;

Tűzveszély:

- Ez a készülék nem használható olyan érzéstelenítő keverék jelenlétében, amely levegővel, oxigénnel vagy dinitrogén-oxiddal gyúlékony.

Áramütés veszélye:

- Az első használat előtt és a termék élettartama során rendszeresen ellenőrizze a készülék szerkezetének és a tápkábelnek a sértetlenségét, hogy nincs-e sérülés; ha megsérült, ne csatlakoztassa a konnektorhoz, és azonnal vigye el a terméket egy hivatalos szervizközpontba vagy az eladóhoz;

- Tartsa távol a tápkábelt állatoktól (például rágcsálóktól), különben az ilyen állatok károsíthatják a tápkábel szigetelését;

- Mindig tartsa távol a tápkábelt a forró felületektől;

- Soha ne takarja el a kompresszoregység mindkét oldalán található szellőzőnyílásokat;

- Ne fogja meg a kompresszor egységet nedves kézzel. Ne használja a kompresszoregységet nedves környezetben (például fürdés vagy zuhanyozás közben). Ne merítse vízbe a kompresszor egységet; ha ez megtörténik, azonnal húzza ki a dugót. Ne húzza vagy érintse meg a kompresszor egységet, amíg az vízbe merült, előbb válassza le. Azonnal viheti egy hivatalos FLAEM szervizbe vagy az eladóhoz.

A terápia hatástalanságának kockázata:

- A teljesítmény bizonyos típusú gyógyszerektől függően változhat (például nagy viszkozitásúak vagy szuszpenzióban). További információkért olvassa el a gyógyszergyártó által biztosított betegtájékoztatót;

- A porlasztót a megfelelő helyzetben, lehetőleg függőlegesen használja; ne döntse meg a porlasztót 30 fokos szögben semmilyen irányba, nehogy a gyógyszer a szájba kerüljön vagy túlzottan szétszóródjon, csökkentve ezzel a kezelés hatékonyságát;

- Ügyeljen a gyógyszerhez mellékelt jelzésekre, és kerülje az ajánlotttól eltérő anyagokat és hígításokat tartalmazó eszközök használatát;

- A készüléket csak pormentes környezetben használja, ellenkező esetben a terápia befolyásolhatja;

- Ne takarja el vagy helyezzen be tárgyakat a szűrőbe és annak házába az egységben;

- Túl sűrű anyagok esetén az orvos előírása szerint megfelelő sóoldattal történő hígításra lehet szükség;

- Csak eredeti FLAEM tartozékokat vagy alkatrészeket használjon, nem vállalunk felelősséget, ha nem eredeti alkatrészeket vagy tartozékokat használ;

Fertőzés veszélye:

- Javasoljuk a tartozékok személyes használatát a fertőzésveszély elkerülése érdekében;

- Minden használat előtt kövesse a higiéniai előkészületeket. Győződjön meg arról, hogy a csöveket és tartozékokat ne tárolja más tartozékok vagy különböző terápiákhoz (például infúziók) szolgáló eszközök közelében;

- A terápia végén ne hagyja a gyógyszert a porlasztóban;

- Ha a porlasztót többféle gyógyszerhez használják, a maradékokat teljesen el kell távolítani. Ezért minden belélegzés után végezzen higiénikus előkészítést, a legmagasabb fokú higiénia elérése és a készülék élettartamának és működésének optimalizálása érdekében is;

Sérülésveszély:

- Ne helyezze a készüléket puha támasztófelületre, például kanapéra, ágyra vagy asztallapra;

- Mindig kemény felületen, tárgy nélkül használja.

Figyelmeztetések a diagnosztikai vizsgálatok során fellépő interferencia kockázatára vonatkozóan

Ezt az eszközt úgy tervezték, hogy megfeleljen a jelenlegi elektromágneses kompatibilitási követelményeknek. Ami az elektromágneses összeférhetőségi követelményeket illeti, az elektroorvosi eszközök felszerelésük és használatuk során különös figyelmet igényelnek, ezért azokat a gyártó specifikációinak megfelelően kell felszerelni és/vagy használni.

Lehetséges elektromágneses interferencia veszélye más eszközökkel. A mobil vagy hordozható rádiófrekvenciás rádió- és távközlési eszközök (mobiltelefonok vagy vezeték nélküli kapcsolatok) zavarhatják az elektroorvosi eszközök működését.

Az eszköz érzékeny lehet az elektromágneses interferenciára, ha más, meghatározott diagnózishoz vagy kezeléshez használt eszközök jelenléte is fennáll. További információért látogasson el a www.flaemnuova.it oldalra.

A hibák esettörténete és megoldása

Bármilyen művelet elvégzése előtt kapcsolja ki az eszközt, és válassza le a hálózatról.

Probléma	**Ok**	**MEGOLDÁS**
A készülék nem működik	A tápkábel nincs megfelelően csatlakoztatva a készülék aljzatához vagy a konnektorhoz	Csatlakoztassa megfelelően a tápkábelt az aljzatokhoz
A készülék nem, vagy nagyon lassan porlaszt	A gyógyszert nem helyezték be a porlasztóba	Öntse a megfelelő mennyiségű gyógyszert a porlasztóba
	A porlasztó nem volt megfelelően összeszerelve	Szerelje szét és szerelje fel megfelelően a porlasztót a burkolaton található csatlakozási rajz szerint
	A porlasztó eltömődött	A porlasztó higiénikus előkészítése. A porlasztó higiénikus előkészítésének hiánya miatti gyógyszerlerakódások befolyásolják annak hatékonyságát és működését. Szigorúan tartsa be a "Higiénés előkészítés" fejezetben található utasításokat.

	A tartozékok nincsenek megfelelően csatlakoztatva a készülékhez	Ellenőrizze a megfelelő csatlakozást a készülék levegőbemenete és a tartozékok között
	A cső meghajlott, sérült vagy megcsavarodott	Tekerje le a tömlőt, és ellenőrizze, hogy nincs-e összenyomva vagy kilyukadva. Cserélje ki a tömlőt, ha szükséges.
	A légszűrő piszkos	Cserélje ki a szűrőt
A készülék zajosabb a szokásosnál	A szűrő nem megfelelő	Helyezze be a megfelelő szűrőt a házba

Ha a fent leírt feltételek ellenőrzése után a készülék továbbra sem működik megfelelően, javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba az eladóval vagy egy hivatalos szervizközponttal.

Hulladékelhelyezés

A 2012/19/EK irányelvvel összhangban a berendezésen lévő szimbólum azt jelzi, hogy a kidobandó berendezés (a tartozékok kivételével) hulladéknak minősül, ezért „külön kell gyűjteni”. Ezért ezt a hulladékot a felhasználónak a helyi hatóságok által létesített szelektív gyűjtőhelyeken kell leadnia (vagy leadnia), vagy új, azonos típusú készülék vásárlásakor át kell adnia a kiskereskedőnek. A hulladék elkülönített gyűjtése és az azt követő kezelési, hasznosítási és ártalmatlanítási műveletek elősegítik a berendezések újrahasznosított anyagokból történő előállítását, és korlátozzák a nem megfelelő hulladékkezelésből adódó negatív környezeti és egészségi hatásokat. A termék felhasználó általi jogosulatlan eltávolítása a 2012/19/EK irányelvet átültető tagállam vagy a termék eltávolításának helye szerinti ország jogszabályai által előírt közigazgatási szankciók alkalmazását vonja maga után.


Értesítés súlyos eseményekről

A termékkel kapcsolatban előforduló súlyos eseményeket haladéktalanul jelenteni kell a gyártónak és az illetékes hatóságnak.

Súlyosnak minősül az esemény, ha közvetlenül vagy közvetve egy személy halálát vagy előre nem látható súlyos egészségromlását okozza vagy okozhatja.

A készüléken vagy a csomagoláson lévő szimbólumok

CE 0051	Orvosi CE jelölés ref. A 2017/745 EU-rendelet és az azt követő frissítések	SN	A készülék sorozatszáma
	II osztályú készülék		Termelő

	Használat előtt: Gondosan ellenőrizze a használati utasítást		Alkalmazott BF típusú alkatrész
	Tovább		Alternatív áram
	Letépett		Óvatos
	Ftalátok és biszfenol nélkül		Védettségi fokozat: IP21 (12 mm-nél nagyobb szilárd tárgyak ellen védett. Ujjas hozzáférés ellen védett; függőlegesen leeső vízcseppek ellen védett)
	Típusszám		Olvassa el a használati utasítást
	Hőmérséklet határok		Páratartalom határok
	A légköri nyomás határértékei		Gyártás dátuma
	Tétel kódja		Egyedi eszközazonosító
			Orvosi eszköz

Információ bizonyos anyagokkal kapcsolatos korlátozásokról vagy összeférhetetlenségről

- Kölcsönhatások: A készülékben felhasznált anyagok biokompatibilis anyagok és megfelelnek a törvényi előírásoknak, azonban az esetleges allergiás reakciók nem zárhatók ki teljesen.

- A felnyitás után a lehető leghamarabb vegye fel a gyógyszert, és ne hagyja a porlasztóban; a terápia befejezése után ne hagyja a gyógyszert a porlasztóban, és folytassa a higiénikus előkészítést.

A kompresszor egység specifikációi

Típus: P0513EM F400

Tápellátás: 230V~ 50Hz 130VA;

Max. Nyomás: 1,8 ± 0,3 bar;

Légáramlás a kompresszor felé: kb. 9 l/perc;

Zajszint (1m-en): 54 dB (A) kb.

Művelet: folytassa

Méret: 18(H) x 16,5(Sz) x 13(Ma) cm.

A porlasztó műszaki adatai

Modell: RF8-3;

RF8 Dual Speed porlasztó

A gyógyszer minimális űrtartalma: 2 ml;

A gyógyszer maximális kapacitása: 8 ml.

A készülék műszaki jellemzői

Modell: P0513EM F400 kombinált RF8-3;

Üzemi nyomás (sűrített levegővel): 0,8 bar.

	Sebességválasztó B2.2.3	
	Maximális pozícióban.	A pozícióban min.
(1) Megjelenés:	0,40 ml/perc kb.	0,19 ml/perc kb.
(2) MMAD:	4.48 μm	4.01 μm
Belélegezhető frakció < 5 μm (FPF):	55.5%	61.1%
(1) A FLAEM belső eljárása szerint gyűjtött adatok. (2) Az in vitro jellemzést a TUV Rheinland Italia S.R.L. végezte. a Pármai Egyetemmel együttműködve. További részletek kérésre elérhetőek.		

Alkalmazott rész

A BF típusú alkalmazott alkatrészek a következők: betegtartozékok (B3, B4, B5).

Súly: 1100 kg

Környezeti feltételek

Üzemeltetési feltételek:

Környezeti hőmérséklet: +10°C és +40°C között;

A levegő relatív páratartalma: 10% és 95% között:

Légköri nyomás: 69 Kpa és 106 Kpa között;

Tárolási és szállítási feltételek:

Környezeti hőmérséklet: -25°C és +70°C között;

A levegő relatív páratartalma: 10% és 95% között;

Légköri nyomás: 69 Kpa és 106 Kpa között.

kifejezést

Típus: P0513EM F400

(Kompresszor egység) Élettartam 400 óra.

Modell: RF8-3 (porlasztó és tartozékok)

A becsült átlagos élettartam 1 év, azonban intenzív használat esetén 6 havonta tanácsos a porlasztót cserélni (vagy hamarabb, ha a porlasztó eltömődött), a maximális terápiás hatékonyság érdekében.

<table>
<tr><th colspan="3">Információk a berendezésekről és anyagokról</th></tr>
<tr><td colspan="2">A felszerelés tartalmazza</td><td>Információk az anyagokról</td></tr>
<tr><td>A -</td><td>Kompresszor egység – Modell: P0513EM F400
A1 – Kapcsoló
A2 – Levegőbemenet
A3 – Légszűrő
A4 – Támogatás a porlasztóhoz
A6 – Tápkábel</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">B-</td><td>Porlasztó és tartozékok – Modell: RF8-3
B1 – Csatlakozócső (kompresszor/porlasztó egység)
B2 – RF8 porlasztó két sebességgel
B2.1 – Alsó rész
B2.2 – Felső rész választóval
B2.2.1 – Felső rész
B2.2.2 – Választókapcsoló támogatása
B2.2.3 – Sebesség választó</td><td></td></tr>
<tr><td>B3 - Mustiuc</td><td>polipropilén</td></tr>
<tr><td>B4 – SoftTouch gyermekmaszk</td><td rowspan="2">Polipropilén + hőre lágyuló elasztomerek</td></tr>
<tr><td>B5 – SoftTouch maszk felnőtteknek</td></tr>
</table>

	Fontos megjegyzés: A csomagoláson azonosító címke található, távolítsa el, és helyezze fel a megfelelő helyre. A porlasztó és a tartozékok cseréjekor végezze el ugyanezt az eljárást.

Használati útmutató

Minden használat előtt alaposan mosson kezet, és tisztítsa meg a készüléket a „Higiénés előkészületek” részben leírtak szerint. Az alkalmazás során ajánlott megfelelően védeni magát a cseppektől. Ez az eszköz olyan gyógyászati anyagok (oldatok és szuszpenziók) beadására alkalmas, amelyeknél aeroszolok beadása megfontolandó; az ilyen anyagokat minden esetben orvosnak kell felírnia. Túl sűrű anyagok esetén az orvos felírása szerint megfelelő sóoldattal történő hígításra lehet szükség.


1. Dugja be a tápkábel csatlakozóját a készülék feszültségének megfelelő aljzatba. Úgy kell elhelyezni, hogy az elektromos hálózatról való leválasztás ne legyen nehéz.

2. Szerelje vissza a felső részt a választókapcsolóval a kapcsolási rajz fejezetben látható módon. B2.2.

Figyelem, a választótartó támasztéknak (B2.2.2) tökéletesen illeszkednie kell a felső részbe (B2.2.1), ehhez a választótartón lévő nyilat a tartozékcsatlakozó bevágásához kell igazítani, lásd a képet.

3. Adja hozzá az orvos által felírt gyógyszert az alsó részbe (B2.1). Helyezze be a felső részt (B2.2) az alsó részbe (B2.1), zárja le a porlasztót a felső rész (B2.2) óramutató járásával megegyező irányba forgatásával.

4. Csatlakoztassa a tartozékokat a burkolaton található "Csatlakozási rajz" szerint.



5. Üljön kényelmesen, miközben a porlasztót a kezében tartja, tegye a szájrészt a szájához, vagy használjon orrrészt (ha van) vagy maszkot. Ha használja a maszktartozékot, helyezze az arcra az ábrán látható módon (gumiszalag használatával vagy anélkül).




6. Kapcsolja be a készüléket a kapcsoló (A1) megnyomásával, és lélegezzen mélyen be és ki; belélegzés után ajánlatos egy pillanatra visszatartani a lélegzetét, hogy a belélegzett aeroszolcseppek leülepedjenek. Ezután lassan lélegezzen ki.

7. Amikor az alkalmazás befejeződött, kapcsolja ki az eszközt, és válassza le a hálózatról.

Figyelem: Ha a terápia után nyilvánvaló nedvességlerakódás képződik a csőben (B1), válassza le a csövet a porlasztóról, és szárítsa meg magának a kompresszornak a szellőzésével; ez a művelet megakadályozza a penész kialakulását a csőben. A csatlakozócső (B1) kompresszoregységhez való csatlakoztatásának megkönnyítése érdekében a végét forgatva és egyidejűleg beillesztve, az eltávolításhoz pedig forgatással és kihúzással végezze.

Az RF8 Dual Speed porlasztó használata sebességválasztóval


Az inhalációs terápia felgyorsításához forgassa el a sebességválasztót az óramutató járásával megegyező irányba.


Az inhalációs terápia hatékonyabbá tétele érdekében forgassa el a sebességválasztót az óramutató járásával ellentétes irányba, ebben az esetben a gyógyszer optimális adagolását éri el, ugyanakkor minimalizálja a gyógyszer szétszóródását a környezetben.

Soft Touch maszkok

A Soft Touch maszkok külső éle puha, biokompatibilis anyagból készült, amely optimális illeszkedést biztosít az arcra, valamint innovatív diszperziókorlátozóval is fel van szerelve. Ezek a jellemzők lehetővé teszik a gyógyszer nagymértékű ülepedését a páciensben, és ismét korlátozzák diszperzióját.


Puha biokompatibilis anyag

Diszperzió korlátozó


Belégzéskor a diszperziót korlátozó fül befelé hajlik a maszkban.


Kilégzéskor a diszperziót korlátozó fül kifelé hajlik a maszkból.

Higiénikus felkészítés

Minden higiéniai előkészítési művelet előtt kapcsolja ki a készüléket, és válassza le a hálózatról. A kompresszor egység (A) és a cső külső része (B1).

Csak antibakteriális tisztítószerrel megnedvesített ruhát használjon (nem súroló hatású és semmilyen oldószer nélkül).

Porlasztó és tartozékok

Nyissa ki a porlasztót úgy, hogy a felső részt (B2.2) az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja, majd szerelje szét a felső részt (B2.2) a B2.2 pontban található "Csatlakozási diagram" szerint. Ezután folytassa az alábbi utasítások szerint.

tisztítás

Minden használat előtt és után fertőtlenítse a porlasztót és a tartozékokat a táblázatban bemutatott és alább ismertetett módszerek valamelyikével.

A módszer: Fertőtlenítse a tartozékokat meleg ivóvíz alatt (kb. 40 °C) könnyen mosható mosogatószerrel (nem súroló hatású).

B módszer: Fertőtlenítse a tartozékokat a mosogatógépben meleg ciklussal (70 °C).

C. módszer: Fertőtlenítse a tartozékokat 50% víz és 50% fehér ecet oldatába áztatva, majd alaposan öblítse le meleg ivóvízzel (kb. 40 °C).

A tartozékok fertőtlenítése után erősen rázza fel és helyezze papírtörlőre, vagy szárítsa meg meleg levegősugárral (például hajszárítóval).

Fertőtlenítés

A porlasztó és a tartozékok fertőtlenítése után fertőtlenítse azokat a táblázatban látható és alább leírt módszerek egyikével. Mindegyik módszer korlátozott számú alkalommal végrehajtható.

A módszer: Szerezzen be egy elektrolit-kloridos fertőtlenítőszert (hatóanyag: nátrium-hipoklorit), amely kifejezetten fertőtlenítésre szolgál, és minden gyógyszertárban kapható.

Végrehajtás:

- Töltsön meg egy megfelelő méretű edényt az összes fertőtlenítendő komponens befogadására szolgáló ivóvíz és fertőtlenítő oldattal, a fertőtlenítőszer csomagolásán feltüntetett arányok betartásával.

- Minden egyes komponenst teljesen merítsen az oldatba, ügyelve arra, hogy az alkatrészekkel érintkezve ne képződjenek légbuborékok. Hagyja a komponenseket a fertőtlenítőszer csomagolásán feltüntetett ideig bemeríteni, és az oldat elkészítéséhez választott koncentrációhoz igazodva.

- Szedje vissza a fertőtlenített alkatrészeket, és alaposan öblítse le meleg ivóvízzel.

- Az oldatot a fertőtlenítőszer gyártójának utasításai szerint ártalmatlanítsa.

B módszer: Fertőtlenítse a tartozékokat úgy, hogy 10 percig vízben forralja; használjon ioncserélt vagy desztillált vizet, hogy elkerülje a kemény víz lerakódását.

C. módszer: A tartozékokat forró üveggőzölőben fertőtlenítse (nem mikrohullámú sütőben). A folyamatot szigorúan a forró palackos gőzölő utasításai szerint hajtsa végre. Ahhoz, hogy a fertőtlenítés hatékony legyen, válasszon legalább 6 perces működési ciklusú sterilizátort.


A tartozékok fertőtlenítése után erősen rázza fel és helyezze papírtörlőre, vagy szárítsa meg meleg levegősugárral (például hajszárítóval).

Minden használat végén tárolja a teljes készüléket a tartozékaival száraz és pormentes helyen.

Levegőszűrés

A készülék elszívószűrővel (A3) van felszerelve, amelyet csereszűrőre kell cserélni, ha az piszkos vagy megváltozik a színe.

Ne mossa vagy használja újra ugyanazt a szűrőt. A szűrő rendszeres cseréje szükséges a kompresszor megfelelő működésének biztosításához. A szűrőt rendszeresen ellenőrizni kell. Lépjen kapcsolatba az eladóval a csereszűrőkért.

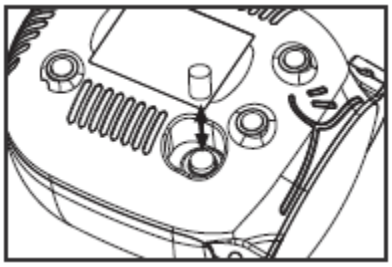

A szűrő cseréjéhez húzza ki az ábrán látható módon.

A szűrőt úgy tervezték, hogy mindig a házába legyen szerelve. Használat közben ne cserélje ki a szűrőt. Csak eredeti Flaem tartozékokat vagy alkatrészeket használjon, nem vállalunk felelősséget, ha nem eredeti alkatrészeket vagy tartozékokat használ.

GARANCIA FELTÉTELEI

1. A jótállási feltételeket a jótállási jegyen közöljük a vásárlóval.

2. A jótállás érvényesítéséhez a jótállási jegy és a számla bemutatása szükséges.

IMPORTŐR: S.C. BIT ONLINE SRL Bukarest, telefon: +40 21 211 06 52, www.bitonline.ro